

Bestellformular

ULTIMATE EARS IN EAR HÖRER



**ULTIMATE
EARS**

PROFESSIONAL

Sehr geehrter Kunde,

Füllen Sie dieses Bestellformular für Ihren UE Custom In-Ear-Hörer bitte vollständig aus. Auf der zweiten Seite finden Sie die Instruktionen für den Hörgeräteakustiker. Bitte drucken Sie dieses Blatt ebenfalls aus und nehmen Sie es zu Ihrem Termin der Ohrabdrucknahme mit und legen Sie es dort vor. Anschließend senden Sie bitte das ausgefüllte Formular gemeinsam mit Ihren Ohrabformungen zu Fischer Amps ein.

Wir senden Ihnen innerhalb von 5 Tagen nach Eingang eine Auftragsbestätigung per Email.

● Hörermodell (Gewünschtes Modell bitte ankreuzen) :

- | | |
|--|---|
| ☐ UE PREMIER (21 Treiber, 5-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE LIVE (8 Treiber, 5-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE 18+ PRO (6 Treiber, 4-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE 11 PRO (4 Treiber, 3-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE 7 PRO (3 Treiber, 2-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE 6+ PRO (3 Treiber, 3-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE 5 PRO (2 Treiber, 2-Wege) | ☐ Ambient Option |
| ☐ UE RR + PRO (3 Treiber, 3-Wege) | ☐ Ambient Option |

● Farbauswahl, siehe Farb- und Designauswahl Seite 3 (bitte eintragen)*: _____

● Weitere Designoptionen: ☐ ohne UE Logo (Aufpreis) ☐ eigenes Logo oder Grafik (Aufpreis)

● Anschlusskabel Länge: ☐ 50' (127 cm) ☐ 64' (164 cm)

● Anschlusskabel Farbe: ☐ transparent ☐ schwarz

● Transportbox: ☐ klein (quadratisch)

● Aufschrift auf Transportbox : _____ (Max. 25 Zeichen)

Weiteres (Bandname etc.) : _____

● Name*: _____ Vorname*: _____

Straße: _____

PLZ : _____ Stadt: _____ Land: _____

Mobiltelefon: _____ Email: _____

Notizen: _____


Mit meiner Unterschrift erteile ich verbindlich den Auftrag und stimme der Verwendung meiner Daten für den Auftrag zu. Meine Daten werden ausschließlich zur Auftragsbearbeitung und zu Produktservicezwecken bei Fischer Amps gespeichert.

Unterschrift*: _____ Datum*: _____

Wichtige Hinweise zur Abnahme von Ohrabformungen für professionelle maßgefertigte In Ear Hörer:

1. Verwenden Sie zur Ohrabdrucknahme feinabzeichnendes, gut fließfähiges Ohrabdruck-Silikon für eine hohe Abformpräzision sowie möglichst zum Durchmesser des Ohrkanals passende, flache Abformpads bzw. angepasste Watte pads.
2. Der Mund sollte bei der Ohrabdrucknahme bis zur Entnahme der Ohrabformungen entspannt geschlossen sein. **Bitte keine Kaubewegungen während des Aushärtevorgangs!**
3. Achten Sie beim Einbringen der Ohrabdruckmasse in das Ohr, **dass alle im Beispielbild gezeigten Areale des äußeren Ohres und bis zum zweiten Knick des Ohrkanals (siehe unten) komplett und ohne Lufteinschlüsse abgeformt werden.** Wichtig ist auch, dass im Bereich der Basis Ohrabdruckmasse aufgebaut wird, da auch der Bereich der äußeren Concha für die Konstruktion der Hörschale und Positionierung des Anschlusssteckers sehr wichtig ist.
4. Falls die fertigen Ohrabformungen mit einem Ohrabdruckscanner gescannt werden, speichern Sie bitte die Scandaten zur Übertragung als Name_Vorname.stl Dateien und senden Sie diese als Dateianhang per E-Mail an info@fischer-amps.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an FISCHER AMPS:
Telefon: +49 6291 64879-0, Email: info@fischer-amps.de

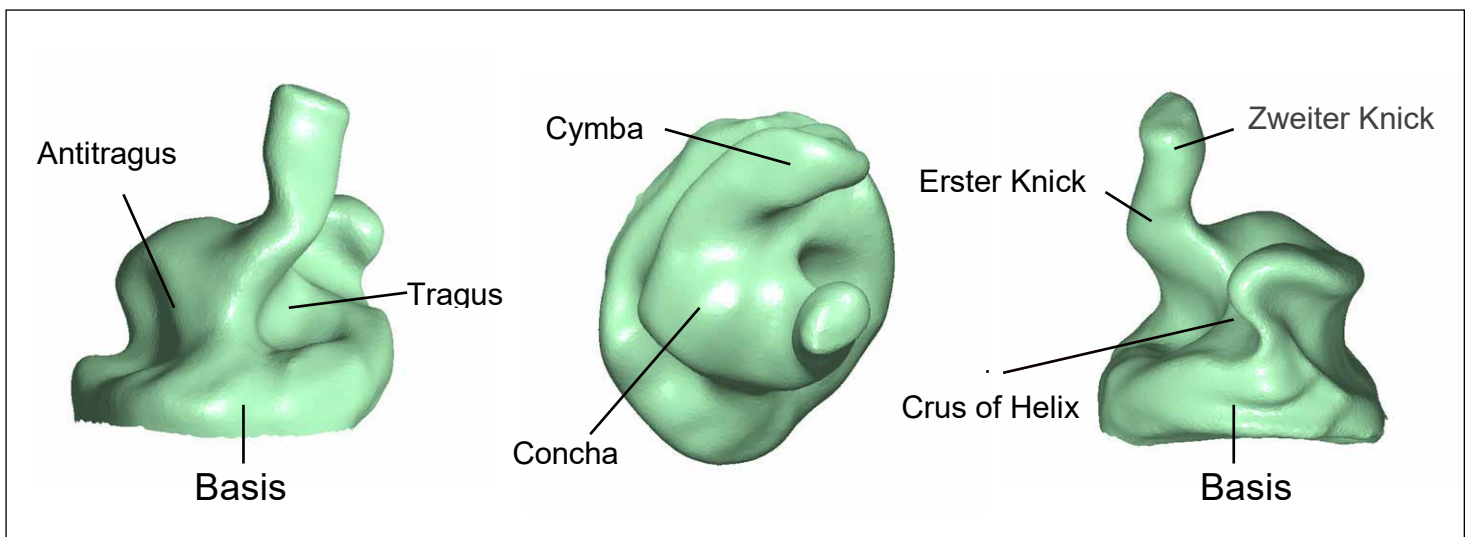

ULTIMATE EARS

PROFESSIONAL

UE LOGO
OHNE AUFPREIS



UE NEW LOGO

EIGENE INITIALEN
AUFPREIS +50 € netto
(MAXIMAL ZWEI BUCHSTABEN)



EIGENE INITIALEN CHROM

UMRANDUNG (HALO)
AUFPREIS +200 € netto



UMRANDUNG GOLD



UMRANDUNG CHROM

UE FARBEN / DESIGNS 2025

TRANSPARENT



OHNE AUFPREIS

OPAK MIT SILBERGLITZER



AUFPREIS +100 € netto

FA FISCHER AMPS

OPAK



OHNE AUFPREIS

SONDERDESIGNS



AUFPREIS +100 € netto

CASES



Dimensions : 8.3 x 7.3 x 4.1 cm



CABLES



The new UE SuperBax cable and IPX connection system.

No phase connector issues.

Strong connection with double spring mechanism.
sweat-proof, weather-proof, tour-proof.

Maximum strong, but also fine cable quality with low impedance.
New fixable neck slider.

Available in 127 cm (50') and 163 cm (64')

Color: transparent and black